



**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

PROGRAMMA

Dati A nalisi M etodi O rganizzazione C onfronti L aboratori E xperti

RING TEST METODI DI RIFERIMENTO LATTE DI VACCA

SETTEMBRE 2017
(LOTTO RTR120917)

VIA DELL'INDUSTRIA 24 - 00057 MACCARESE ROMA
Tel. 06 6678830 Fax. 06 6678811 e-mail lsl@aia.it



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

RING TEST RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 INDICE

Indice	pag. 2
Norme e documenti di riferimento.....	pag. 3
Guida all'interpretazione del ring test	pag. 4
Valutazione del ring test	pag. 5
Elenco laboratori.....	pag. 8
Omogeneità	pag. 9
Andamento Z-Score.....	pag.10
Ranking.....	pag.11
Grasso	pag.12
Proteine	pag.15
Caseine	pag.18



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per l'organizzazione e l'elaborazione dei dati del RING TEST, il Laboratorio Standard Latte segue in modo conforme i requisiti previsti nei seguenti documenti o norme:

- ILAC - G13: 2007 (Guidelines for the requirements for the competence of providers of proficiency testing schemes);
- ISO 5725 – 2: 1994 – Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – part 2;
- Pure & Appl. Chem. Vol. 65, n°9 pp.2123-2144, 1993 (The International harmonized protocol for the proficiency testing of analytical laboratories);
- ISO/IEC 17043:2010 (Conformity assessment – General Requirements for proficiency testing)

Il Laboratorio Standard Latte dell'AIA ha il Sistema di Gestione per la Qualità certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001-2008 dal CSQA con il seguente scopo: Progettazione, preparazione e commercializzazione di materiali di riferimento certificati nel settore lattiero-caseario. Progettazione, organizzazione e realizzazione di prove valutative interlaboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott.ssa Annunziata Fontana)



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE DEL RING TEST

1. Numero di identificazione del laboratorio che viene assegnato ad ogni Ring Test. La chiave identificativa viene comunicata via e-mail e deve essere riportata in calce all'elenco dei laboratori partecipanti.
2. Numero identificativo dei campioni. Sequenzialmente è riportata la prima e la seconda ripetizione di analisi. In alcune elaborazioni, es. contenuto del grasso, per motivi di spazio è riportata solo la media dei due risultati.
3. Media delle due ripetizioni e media aritmetica di tutti i risultati di analisi.
4. Nel riquadro che è stampato in tutte le pagine, sono riportate: la media aritmetica (Media), il valore minimo (Min), quello massimo (Max), lo scarto tipo (ST) e il valore di riferimento (Val Ass.). Quest'ultimo è rappresentato dalla mediana ed è considerato il valore "vero" a cui far riferimento per tutte le elaborazioni e confronti. Sia nel calcolo della media che nel calcolo della mediana non sono considerati i campioni outlier. Nell'ultima riga sono riportati i valori calcolati sulle medie dei laboratori.
5. I valori dei campioni outlier al test di Cochran e di Grubbs (vedi tabella Ripetibilità – Riproducibilità – Outlier specifica per ogni analista) sono stampati in grassetto. **L'elaborazione non può essere effettuata quando il numero dei partecipanti non è sufficiente.**
6. Risultato mancante, sostituito con il corrispondente valore della mediana, al fine di poter calcolare lo Z Score della media dei risultati. Le cifre sono inserite in un riquadro.
7. Per memoria si ricorda la formula dello ZS: *risultato lab – Val Rif / scarto tipo dei risultati considerati.* In questa parte della tabella sono riportati i risultati del calcolo dello Z Score:
 - calcolato per singolo campione (ZS CAMP);
 - calcolato con la media del laboratorio meno la media del valore di riferimento (mediana) e lo scarto tipo (ST) delle medie di tutti i laboratori (ZS LAB);
 - calcolato utilizzando uno scarto tipo (ST fisso) uguale per tutti i ring test. Standardizzando la ST è possibile confrontare nel tempo le "performance" ottenute.
8. In questa parte della tabella sono riportate:
 - la differenza di ogni singolo campione dal valore di riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4);
 - la media aritmetica delle singole differenze (m diff);
 - lo scarto tipo delle differenze (st diff)
 - la distanza euclidiana (D) o distanza dagli assi ed è calcolata come radice quadrata della somma dei quadrati di m diff e st diff. Utilizzando il valore di "D" è possibile ottenere un ordinamento dei laboratori.
9. In questa parte della tabella sono riportati:
 - lo slope o pendenza della retta (SLOPE);
 - il bias o intercetta (BIAS);
 - la correlazione (CORR).

Per il calcolo si utilizzano i risultati dei singoli laboratori e il Valore di Riferimento riportato nel riquadro (v. punto 4).



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

VALUTAZIONE DEL RING TEST

Nella descrizione della valutazione del Ring Test sarà seguita l'impaginazione del documento. L'argomento trattato sarà indicato dal nome o riferimento alla tabella.

➤ Andamento generale dei Ring Test

Sui grafici da pagina 11 a 16 sono riportati i confronti tra i risultati dei ring test effettuati nell'arco di almeno due anni.

➤ Ordinamento laboratori

Nella tabella a pagina 10 è riportato l'ordinamento dei laboratori ottenuto dal calcolo della distanza eucliana secondo la seguente formula:

$$D = \sqrt{(m \text{ diff})^2 + st^2}$$

dove:

D = distanza eucliana dall'origine degli assi;

m diff = differenza tra la media dei risultati del laboratorio ed il valore di riferimento;

st = scarto tipo delle differenze tra i singoli risultati del laboratorio e i singoli valori di riferimento.

La differenza dal valore di riferimento (m diff) e lo scarto tipo delle differenze (ST) sono rilevabili nelle tabelle che riportano i risultati analitici.

Per monitorare nel tempo i propri risultati ottenuti nei singoli Ring Test, si dovrebbe riportare la percentuale dell'ordinamento (pag. 10) su una carta di controllo.

➤ Tabelle riportanti i risultati

Lo Z Score è calcolato mediante la seguente formula:

$$ZS = \frac{m - VAL\ RIF}{st}$$

dove:

m = media dei risultati di analisi di ogni laboratorio;

VAL RIF = mediana dei risultati di analisi dopo eliminazione degli outliers al test di Grubbs;

st = scarto tipo o deviazione standard dalla media;



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

Come riportato nella pubblicazione “The international harmonized protocol for the proficiency testing of (chemical) analytical laboratories (Pure & Appl. Chem. Vol. 65, n. 9 pp 2123 – 2144, 1993) è possibile la seguente classificazione:

Z < 2	Soddisfacente
2 < Z > 3	Dubbio
Z > 3	Insoddisfacente

In altri termini, i laboratori compresi tra 0 e 1 di ZS sono nella situazione auspicabile. Quelli compresi nella fascia tra 1 e 2 hanno una posizione soddisfacente. I laboratori compresi tra 2 e 3 sono nella fascia di allarme e quelli posti oltre il 3 sono “fuori controllo”.

Sono stati calcolati i singoli ZS per ogni campione. La valutazione di cui sopra dovrebbe essere applicata per ogni singolo campione.

E’ riportato, inoltre, il valore dello ZS con al denominatore la ST fissa (target annuale). Ciò consente di confrontare nel tempo le prestazioni dei singoli laboratori. I valori di scarto tipo “fisso” (ST fisso), stabiliti in base alle analisi eseguite sul latte di vacca con il metodo di riferimento, per l’anno in corso sono i seguenti:

- Contenuto in grasso 0.03
- Contenuto in proteine 0.07

E’ consigliabile riportare su carte di controllo i valori di ZS con st fisso del proprio laboratorio per poterli confrontare con i ring test successivi.

Per monitorare nel tempo i propri risultati ottenuti nei singoli Ring Test, si dovrebbe riportare la percentuale dell’ordinamento (%D) su una carta di controllo.



RING TEST ROUTINE
LATTE DI
CONTENUTO IN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	3,56	3,53	3,56	3,55	3,56	3,55	3,53	3,55	3,57	3,53	3,58	3,60	3,52	3,55	3,55	3,59	3,62
	2	4,68	4,66	4,66	4,67	4,67	4,63	4,62	4,64	4,67	4,70	4,68	4,71	4,67	4,66	4,68	4,70	4,68
	3	5,78	5,78	5,78	5,75	5,80	5,75	5,79	5,80	5,79	5,85	5,81	5,82	5,83	5,80	5,81	5,80	5,76
	4	6,31	6,26	6,32	6,32	6,35	6,29	6,31	6,36	6,34	6,38	6,37	6,34	6,37	6,31	6,33	6,31	6,29
	5	7,95	7,99	7,95	7,91	7,95	7,87	7,93	7,94	7,96	7,98	7,97	7,87	7,93	7,95	7,93	7,97	7,99
	1	3,54	3,51	3,54	3,54	3,55	3,56	3,54	3,55	3,57	3,48	3,55	3,60	3,52	3,55	3,58	3,58	3,62
	2	4,63	4,67	4,65	4,65	4,65	4,64	4,62	4,64	4,67	4,68	4,62	4,72	4,63	4,66	4,66	4,66	4,67
	3	5,76	5,80	5,77	5,76	5,80	5,75	5,78	5,80	5,79	5,84	5,80	5,82	5,81	5,81	5,80	5,77	5,75
	4	6,32	6,27	6,31	6,28	6,35	6,29	6,30	6,36	6,34	6,37	6,33	6,31	6,32	6,31	6,33	6,29	6,29
	5	7,97	8,03	7,91	7,90	7,97	7,88	7,91	7,93	7,96	7,99	7,96	7,93	7,95	7,95	7,93	7,95	8,00
MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI																		
3	1	3,55	3,52	3,55	3,55	3,56	3,56	3,54	3,55	3,51	3,51	3,56	3,60	3,53	3,55	3,59	3,62	3,55
	2	4,66	4,67	4,66	4,66	4,66	4,64	4,62	4,64	4,67	4,69	4,65	4,72	4,67	4,66	4,70	4,66	4,66
	3	5,77	5,79	5,78	5,76	5,80	5,75	5,79	5,79	5,85	5,81	5,82	5,83	5,81	5,81	5,80	5,77	5,79
	4	6,32	6,27	6,32	6,30	6,35	6,31	6,30	6,31	6,35	6,34	6,37	6,32	6,32	6,33	6,29	6,32	6,32
	5	7,96	8,01	7,93	7,91	7,96	7,93	7,94	7	7,99	7,97	7,87	7,93	7,95	7,95	7,93	7,95	7,95
	m lab	6,214	6,214	6,198	6,232	6,166	6,166	6,226	6,226	6,237	6,231	6,209	6,228	6,228	6,228	6,217	6,216	6,246
		6,218	6,166	6,246	0,018	6,226												
	5																	
	6																	
	7																	
Z SCORE CALCOLATO CON IL VALORE ASSEGNAUTO																		
7	ZS CAMP,1	0,000	-1,091	0,000	-0,182	0,182	0,182	-0,546	0,000	0,728	-1,637	0,546	1,819	-0,909	0,000	0,000	1,273	1,273 2,546
	ZS CAMP,2	-0,229	0,229	-0,229	0,000	0,000	-1,146	-1,833	-0,917	0,458	1,375	-0,458	2,521	0,229	0,000	0,000	1,833	-0,229 0,688
	ZS CAMP,3	-0,785	0,000	-0,589	-1,374	0,393	-1,570	-0,196	0,393	0,000	2,159	0,589	1,178	1,570	0,589	0,589	0,393	-0,785 -1,374
	ZS CAMP,4	0,000	-1,671	0,000	-0,501	1,170	-0,836	-0,334	1,504	0,836	2,005	1,170	0,836	1,838	0,000	0,000	0,501	-0,836 -0,836
	ZS CAMP,5	0,278	1,671	-0,557	-1,253	0,278	-2,088	-0,835	-0,418	0,278	0,975	0,418	-2,228	-0,557	0,000	0,000	-0,557	0,000 1,253
	ZS LAB	-0,882	-0,650	-0,650	-1,532	0,325	-3,343	-1,672	0,000	0,186	0,604	0,279	-0,929	0,139	0,093	0,093	-0,511	-0,557 1,114
	ZS (ST FISSO)	-0,528	-0,389	-0,389	-0,917	0,194	-2,000	-1,000	0,000	0,111	0,361	0,167	-0,556	0,083	0,056	0,056	-0,306	-0,333 0,667
	8																	
DIFERENZE DAL VALORE ASSEGNAUTO																		
8	1	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,04	0,02	0,05	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,04 0,07
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	-0,02	0,01	0,03	-0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00 0,01
	3	-0,02	0,00	-0,01	-0,04	0,01	-0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,01	0,03	0,04	0,01	0,01	-0,02	-0,04
	4	0,00	-0,05	0,00	-0,02	0,03	-0,03	-0,01	0,04	0,02	0,06	0,03	0,02	0,05	0,00	0,00	0,01	-0,03 -0,03
	5	0,01	0,06	-0,02	-0,04	0,01	-0,08	-0,03	-0,02	0,01	0,04	0,01	-0,08	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00 0,04
	m diff	-0,008	-0,004	-0,004	-0,020	0,013	-0,053	-0,023	0,007	0,011	0,018	0,013	-0,009	0,010	0,009	0,009	-0,002	-0,003 0,028
	st diff	0,016	0,037	0,012	0,017	0,013	0,057	0,014	0,025	0,010	0,043	0,015	0,079	0,032	0,016	0,016	0,048	0,021 0,052
	D	0,018	0,038	0,013	0,026	0,018	0,077	0,027	0,026	0,015	0,047	0,019	0,079	0,033	0,019	0,019	0,048	0,021 0,059
	9																	
	SLOPE	1,003	0,993	0,999	1,005	0,997	1,026	1,002	0,996	1,002	0,997	0,999	1,037	0,998	0,995	0,995	1,022	1,004 0,992
VALORI IN GRASSETTO: VALORI OUTLIERS PER IL TEST DI COCHRAN E/O GRUBBS VALORI NEL RIGUADRO: VALORI SOSTITUITI CON IL VALORE ASSEGNAUTO																		



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

ELENCO DEI LABORATORI PARTECIPANTI RING TEST DI RIFERIMENTO LATTE DI VACCA

HANNO PARTECIPATO I SEGUENTI LABORATORI:

AIA-LSL
ARA LOMBARDIA CREMA
ARA PIEMONTE TORINO
CBA CHEMIE-BIO MARSICOVETERE (PZ)
CORFILAC RAGUSA
DIP. REPRESSIONE FRODI PERUGIA
ECO-FOOD ANALISI VALLATA (AV)
GRANAROLO BOLOGNA
GRANAROLO USMATE VELATE (MI)
LABORATORIO SAN CARLO GROTTAMINARDA (AV)
LABORATORIUM OCENY PRUSZKOW (POLONIA)
LATTERIA SORESINA (CR)

VS. CODICE.....

Invio dei campioni	12/09/2017
Data indicata per l'invio dei risultati	21/09/2017
% dei risultati ricevuti nei limiti indicati	80%
Ultimi risultati ricevuti	25/09/2017
Invio delle elaborazioni statistiche	02/10/2017
Giorni impiegati tra l'invio dei campioni e l'elaborazione	20
Elaborazione effettuata da	Alessandro Di Vincenzi



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

OMOGENEITA' E INCERTEZZA DI MISURA (LOTTO RTR 120917)

GRASSO (g/100g)					
Camp.	Val. Ass.	Oss	IC	Omog	$\pm U$
1	4,820	9	0,0000	0,0069	0,0138
2	3,065	9	0,0000	0,0042	0,0084
3	2,410	9	0,0000	0,0067	0,0134
4	4,025	9	0,0000	0,0000	0,0000
5	3,490	9	0,0000	0,0000	0,0000
6	4,275	9	0,0000	0,0000	0,0000

PROTEINE (g/100g)					
Camp.	Val. Ass.	Oss	IC	Omog	$\pm U$
1	3,795	11	0,0000	0,0069	0,0138
2	2,850	11	0,0000	0,0042	0,0084
3	3,270	11	0,0000	0,0067	0,0134
4	2,940	11	0,0000	0,0000	0,0000
5	3,370	11	0,0000	0,0000	0,0000
6	3,300	11	0,0000	0,0000	0,0000

Legenda:

Val. Ass. = Indica il valore assegnato a cui far riferimento per tutte le elaborazioni e confronti.

Oss = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica (numero degli strumenti utili moltiplicato per le due ripetizioni).

IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate. Omog = Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti.


$\pm U$ = Si assume come incertezza estesa del valore di riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2.

Si dichiara che è stato effettuato, alla scadenza della data di esecuzione del Ring Test (21/09/2017), il test di stabilità dei campioni con esito positivo.




ANDAMENTO RING TEST METODI DI RIFERIMENTO LATTE VACCINO ANNO 2012-2013-2014-2015-2016-2017 FREQUENZE % CLASSI Z-SCORE

GRASSO

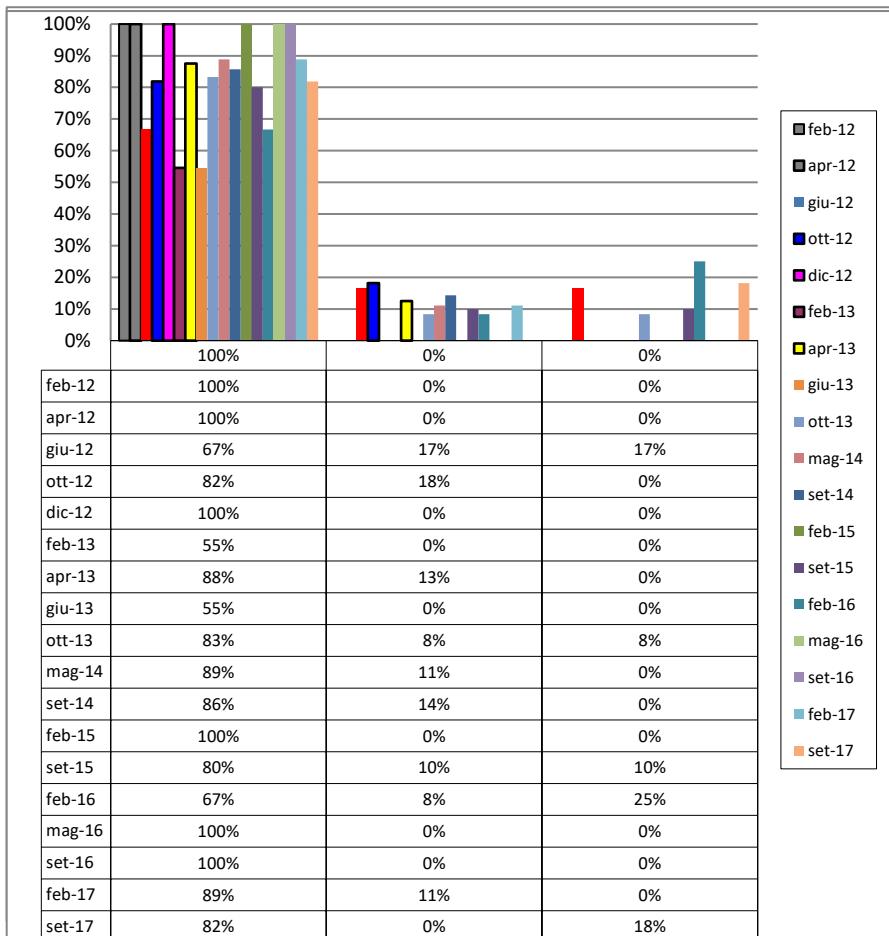

PROTEINE

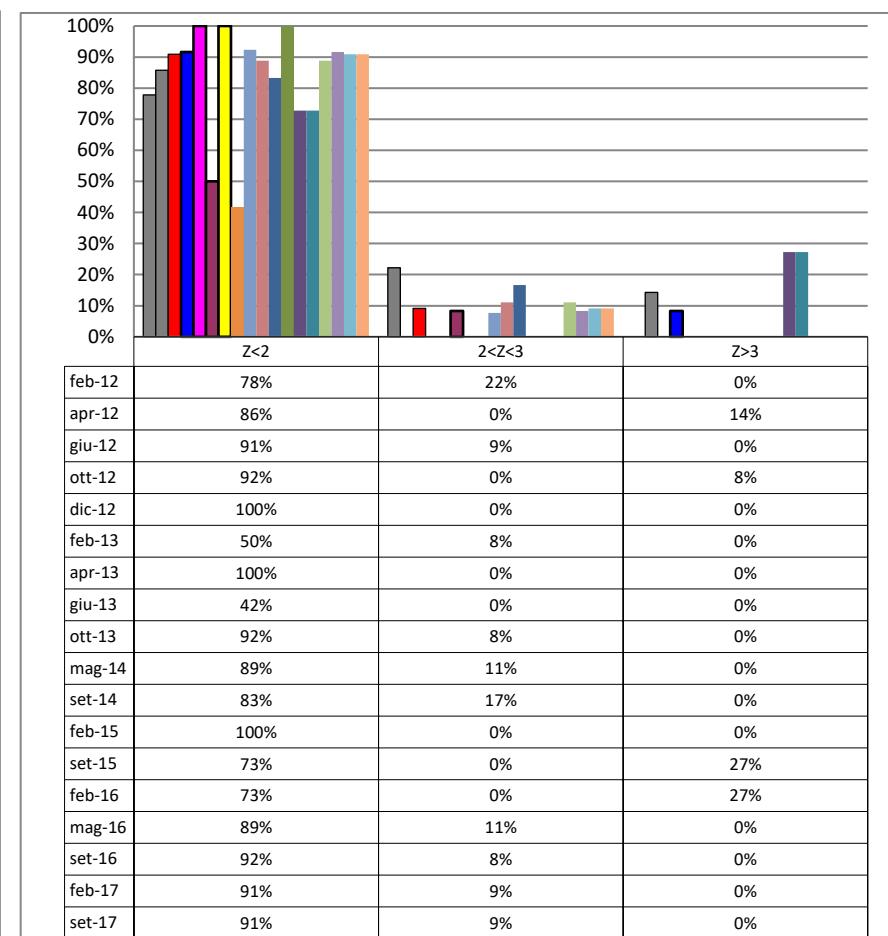



ORDINAMENTO LABORATORI RING TEST RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017

GRASSO				PROTEINE			
ORD	LAB	D	%	ORD	LAB	D	%
1	12	0,021	28%	1	2	0,014	5%
2	10	0,023	30%	2	5	0,015	5%
3	7	0,028	36%	3	6	0,021	7%
4	5	0,028	36%	4	1	0,028	9%
5	6	0,043	56%	5	12	0,039	14%
6	11	0,050	65%	6	8	0,067	23%
7	1	0,053	68%	7	7	0,088	30%
8	9	0,064	82%	8	11	0,108	37%
9	3	0,077	100%	9	10	0,234	80%
				10	3	0,259	89%
				11	4	0,291	100%

LEGENDA:

$$\sqrt{(m \text{ diff})^2 + st^2}$$

dove m diff = m lab - valore di riferimento;
 st = scarto tipo delle differenze

I VALORI ALL'INTERNO DEL RIQUADRO SONO RELATIVI A LABORATORI CHE HANNO ALMENO UN VALORE SOSTITUITO CON IL VALORE DI RIFERIMENTO
NON SONO RIPORTATI NEL RANKING I LABORATORI CHE SI DISCOSTANO PIU' DEL 30% DALL'ULTIMO LABORATORIO CLASSIFICATO



RING TEST RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017

CONTENUTO IN GRASSO g/100g

	1	2	3	4*	5	6	7	8	9*	10	11	12
1	4,79	4,81	4,83	4,60	4,85	4,85	4,78		4,80	4,83	4,85	4,81
2	3,02	3,98	3,05	3,10	3,07	3,07	3,03		3,05	3,05	3,09	3,06
3	2,41	2,35	2,41	2,50	2,48	2,47	2,39		2,40	2,41	2,43	2,43
4	3,93	3,82	4,15	3,90	4,01	4,04	3,99		4,00	4,03	4,06	4,01
5	3,40	3,30	3,56	3,40	3,50	3,50	3,48		3,40	3,49	3,58	3,49
6	4,23	4,19	4,34	4,20	4,17	4,35	4,28		4,20	4,33	4,25	4,31
1	4,82	4,82	4,86	4,60	4,84	4,86	4,79		4,70	4,81	4,84	4,81
2	3,03	2,96	3,08	3,10	3,07	3,06	3,04		3,10	3,05	3,10	3,05
3	2,37	2,37	2,38	2,50	2,41	2,47	2,38		2,35	2,41	2,44	2,43
4	3,96	3,82	4,18	3,90	4,04	4,05	3,98		3,95	4,03	4,05	4,02
5	3,43	3,31	3,58	3,40	3,49	3,51	3,49		3,45	3,48	3,60	3,49
6	4,24	4,17	4,36	4,20	4,29	4,34	4,27		4,15	4,32	4,26	4,32

MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI

	1	2	3	4*	5	6		MEDIA	MIN	MAX	ST	VAL ASS
1	4,805	4,815	4,845	4,600	4,845	4,855	4,785	4,750	4,820	4,845	4,810	4,820
2	3,025	3,470	3,065	3,100	3,070	3,065	3,035	3,075	3,050	3,095	3,055	3,065
3	2,390	2,360	2,395	2,500	2,445	2,470	2,385	2,375	2,410	2,435	2,430	2,410
4	3,945	3,820	4,165	3,900	4,025	4,045	3,985	3,975	4,030	4,055	4,015	4,025
5	3,415	3,305	3,570	3,400	3,495	3,505	3,485	3,425	3,485	3,590	0,084	3,490
6	4,235	4,180	4,350	4,200	4,230	4,345	4,275	4,175	4,325	4,255	4,315	4,275
m lab	3,636	3,658	3,732	3,525	3,685	3,714	3,658	3,544	3,687	3,713	3,686	3,686

Z SCORE CALCOLATO CON IL VALORE ASSEGNAZIONATO


ZS CAMP. 1	-0,636	-0,212	1,060	-9,328	1,060	1,484	-1,484	-2,968	0,000	1,060	-0,424
ZS CAMP. 2	-0,288	2,914	0,000	0,252	0,036	0,000	-0,216	0,072	-0,108	0,216	-0,072
ZS CAMP. 3	-0,580	-1,451	-0,435	2,612	1,016	1,741	-0,725	-1,016	0,000	0,725	0,580
ZS CAMP. 4	-0,862	-2,209	1,509	-1,347	0,000	0,216	-0,431	-0,539	0,054	0,323	-0,108
ZS CAMP. 5	-0,896	-2,211	0,956	-1,076	0,060	0,179	-0,060	-0,777	-0,060	1,195	0,000
ZS CAMP. 6	-0,682	-1,619	1,278	-1,278	-0,767	1,193	0,000	-1,704	0,852	-0,341	0,682
ZS LAB	-1,619	-0,891	1,484	-5,209	-0,027	0,918	-0,891	-4,602	0,027	0,864	0,000
zs (st fisso)	-1,667	-0,917	1,528	-5,361	-0,028	0,944	-0,917	-4,736	0,028	0,889	0,000

DIFFERENZE DAL VALORE ASSEGNAZIONATO

1	-0,015	-0,005	0,025	-0,220	0,025	0,035	-0,035	-0,070	0,000	0,025	-0,010
2	-0,040	0,405	0,000	0,035	0,005	0,000	-0,030	0,010	-0,015	0,030	-0,010
3	-0,020	-0,050	-0,015	0,090	0,035	0,060	-0,025	-0,035	0,000	0,025	0,020
4	-0,080	-0,205	0,140	-0,125	0,000	0,020	-0,040	-0,050	0,005	0,030	-0,010
5	-0,075	-0,185	0,080	-0,090	0,005	0,015	-0,005	-0,065	-0,005	0,100	0,000
6	-0,040	-0,095	0,075	-0,075	-0,045	0,070	0,000	-0,100	0,050	-0,020	0,040
m diff	-0,045	-0,023	0,051	-0,064	0,004	0,033	-0,023	-0,052	0,006	0,032	0,005
st diff	0,027	0,223	0,058	0,112	0,028	0,027	0,016	0,037	0,023	0,039	0,021
D	0,053	0,224	0,077	0,129	0,028	0,043	0,028	0,064	0,023	0,050	0,021
SLOPE	1,000	1,010	0,965	1,134	1,012	0,997	1,000	1,027	0,989	1,009	1,002
BIAS	0,045	-0,014	0,079	-0,420	-0,047	-0,021	0,021	-0,048	0,036	-0,067	-0,013
CORREL.	1,000	0,967	0,998	0,999	1,000	1,000	1,000	0,999	1,000	0,999	1,000


LIMITI DI ISO1211/IDF1D:2010 r=0,04 g/100g

* = LABORATORI CHE HANNO EFFETTUATO L'ANALISI CON IL METODO GERBER NON INSERITO NEL CALCOLO DI r e R

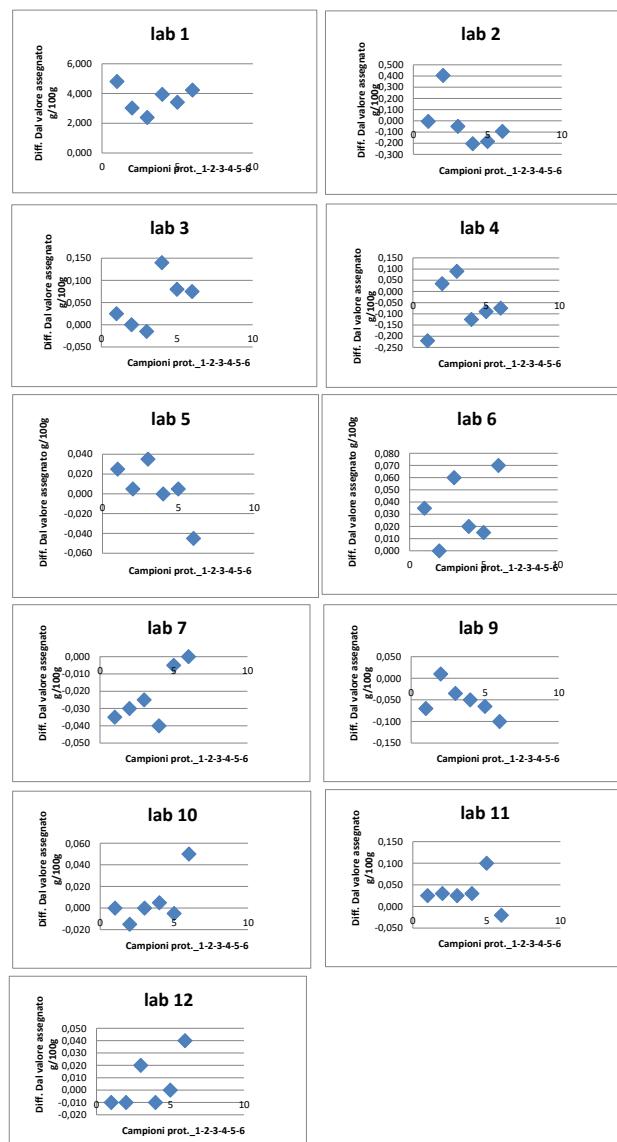




RING TEST METODI DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017
ORDINAMENTO LABORATORI
CONTENUTO IN GRASSO g/100g

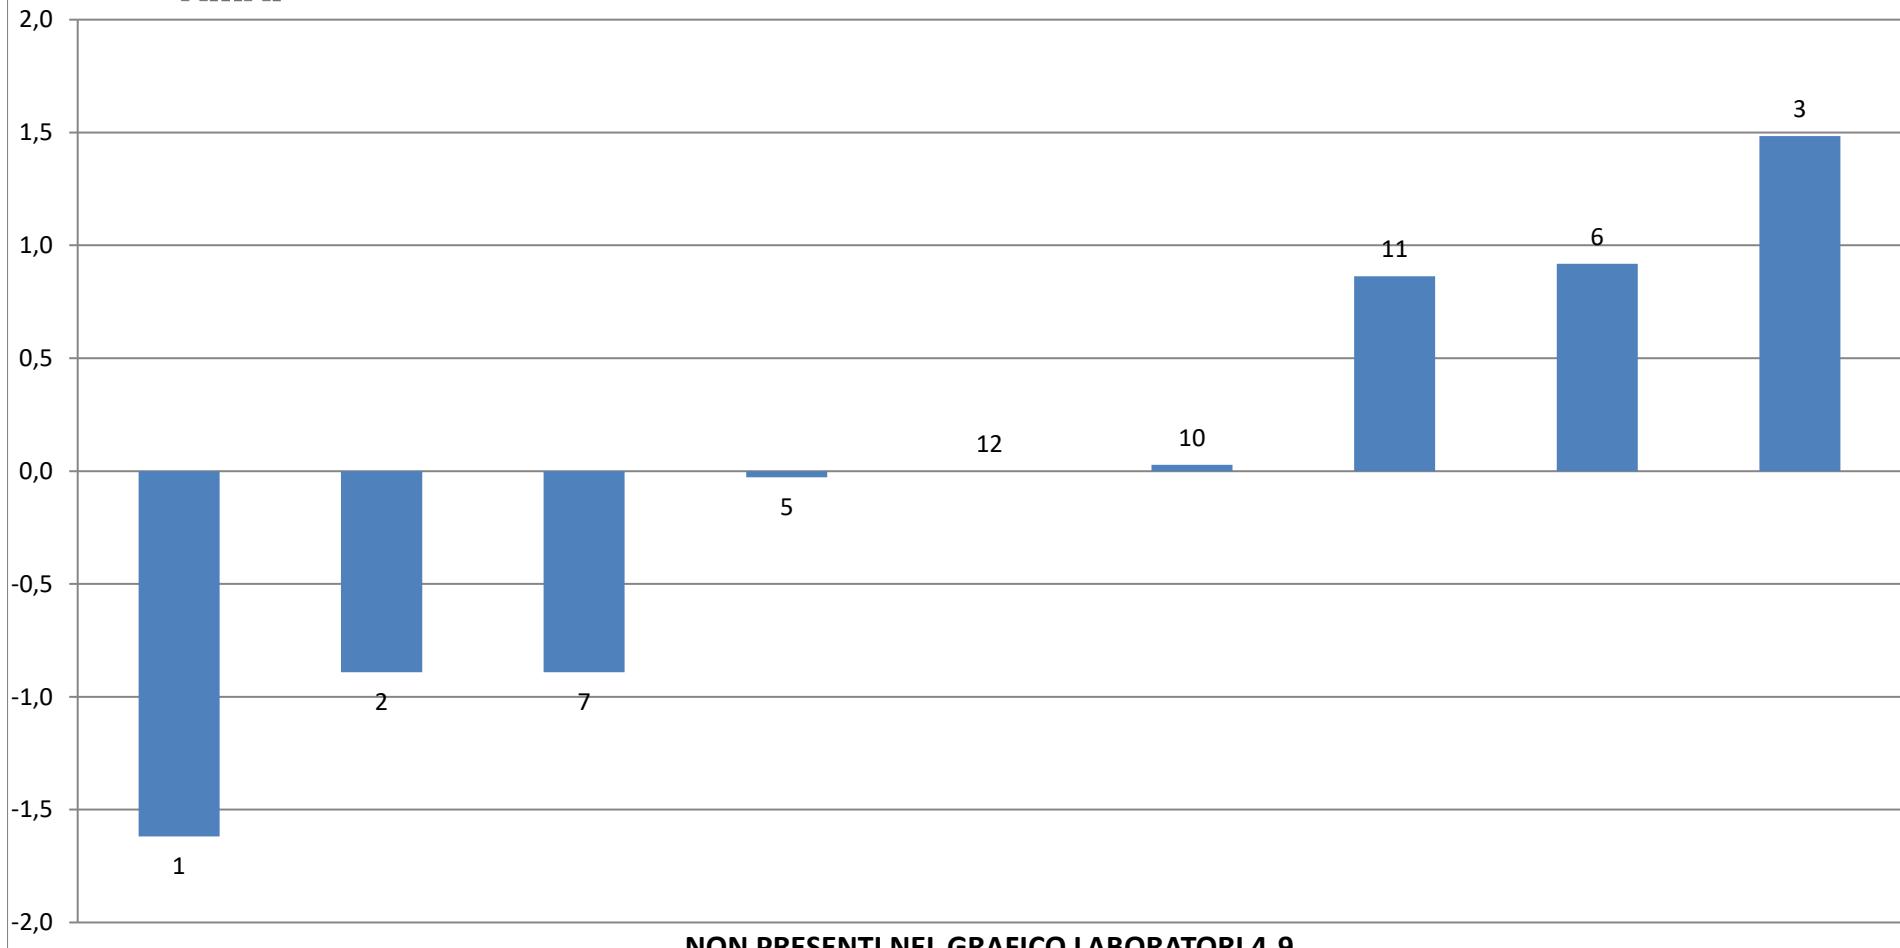



RING TEST METODI DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 CONTENUTO IN GRASSO g/100g

DEVIAZIONE STANDARD DELLE DIFFERENZE

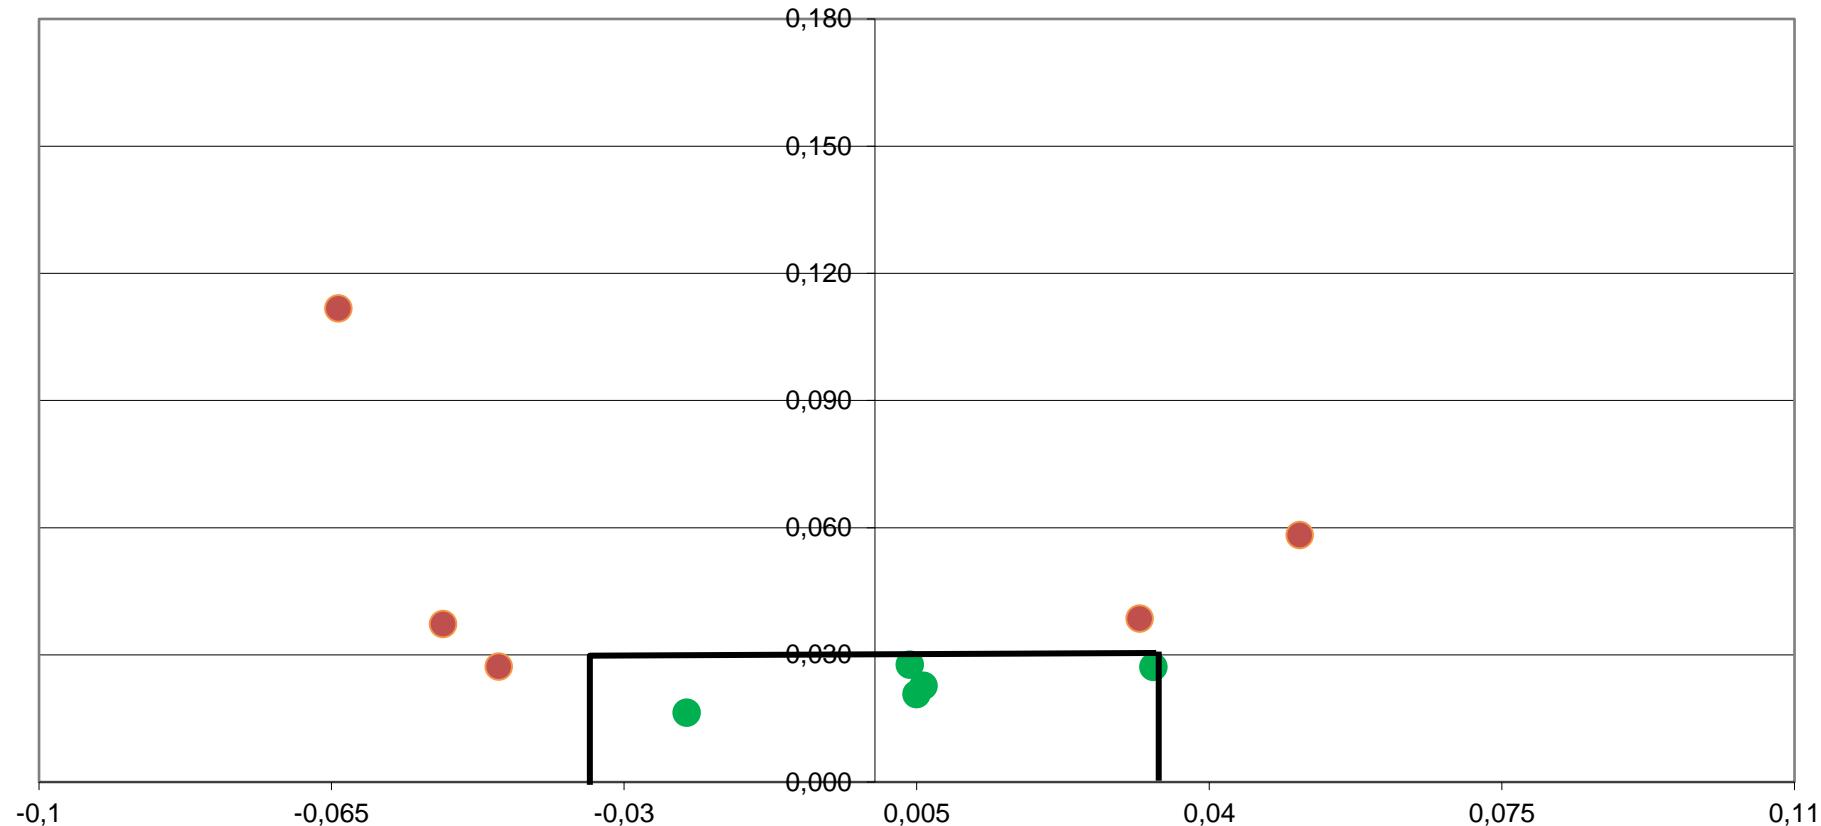



RING TEST RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017

CONTENUTO IN PROTEINE g/100g

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3,78	3,84	3,64	3,45	3,80	3,79	3,84	3,66	3,81	3,93	3,77	
2	2,83	2,85	2,65	3,35	2,83	2,83	2,92	2,82	3,23	2,93	2,90	
3	3,23	3,26	3,04	3,40	3,25	3,26	3,44	3,23	3,65	3,38	3,31	
4	2,88	2,93	2,61	3,15	2,94	2,90	2,94	2,88	2,97	3,01	2,95	
5	3,35	3,40	3,09	3,35	3,35	3,36	3,42	3,37	3,52	3,41	3,41	
6	3,29	3,30	3,01	3,30	3,31	3,29	3,36	3,29	3,33	3,44	3,31	
1	3,80	3,80	3,61	3,45	3,81	3,80	3,85	3,66	3,81	3,95	3,76	
2	2,83	2,85	2,62	3,35	2,84	2,83	2,94	2,82	3,10	2,92	2,92	
3	3,25	3,28	3,01	3,40	3,26	3,26	3,44	3,23	3,76	3,37	3,33	
4	2,90	2,96	2,64	3,15	2,90	2,90	2,95	2,88	2,95	3,04	2,93	
5	3,35	3,38	3,06	3,35	3,36	3,35	3,42	3,37	3,38	3,42	3,38	
6	3,29	3,31	3,03	3,30	3,27	3,30	3,35	3,29	3,32	3,45	3,34	

MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI

		MEDIA	MIN	MAX	ST	VAL ASS
1	3,790	3,820	3,625	3,450	3,805	3,795
2	2,830	2,850	2,635	3,350	2,835	2,830
3	3,240	3,270	3,025	3,400	3,255	3,260
4	2,890	2,945	2,625	3,150	2,920	2,900
5	3,350	3,390	3,075	3,350	3,355	3,355
6	3,290	3,305	3,020	3,300	3,290	3,295
m lab	3,232	3,263	3,001	3,333	3,243	3,239
					3,239	3,208
		3,403	3,354	3,276		3,263

Z SCORE CALCOLATO CON IL VALORE ASSEGNAUTO

ZS CAMP. 1	-0,038	0,190	-1,289	-2,616	0,076	0,000	0,379	-1,024	0,114	1,099	-0,227
ZS CAMP. 2	-0,105	0,000	-1,126	2,619	-0,079	-0,105	0,419	-0,157	1,650	0,393	0,314
ZS CAMP. 3	-0,178	0,000	-1,454	0,772	-0,089	-0,059	1,009	-0,237	2,582	0,623	0,297
ZS CAMP. 4	-0,399	0,040	-2,516	1,677	-0,160	-0,319	0,040	-0,479	0,160	0,679	0,000
ZS CAMP. 5	-0,202	0,202	-2,975	-0,202	-0,151	-0,151	0,504	0,000	0,807	0,454	0,252
ZS CAMP. 6	-0,098	0,049	-2,749	0,000	-0,098	-0,049	0,540	-0,098	0,245	1,424	0,245


ZS LAB	-0,302	0,000	-2,502	0,667	-0,191	-0,230	0,564	-0,524	1,327	0,866	0,119
ZS (ST FISSO)	-0,452	0,000	-3,750	1,000	-0,286	-0,345	0,845	-0,786	1,988	1,298	0,179

DIFFERENZE DAL VALORE ASSEGNAUTO

1	-0,005	0,025	-0,170	-0,345	0,010	0,000	0,050	-0,135	0,015	0,145	-0,030
2	-0,020	0,000	-0,215	0,500	-0,015	-0,020	0,080	-0,030	0,315	0,075	0,060
3	-0,030	0,000	-0,245	0,130	-0,015	-0,010	0,170	-0,040	0,435	0,105	0,050
4	-0,050	0,005	-0,315	0,210	-0,020	-0,040	0,005	-0,060	0,020	0,085	0,000
5	-0,020	0,020	-0,295	-0,020	-0,015	-0,015	0,050	0,000	0,080	0,045	0,025
6	-0,010	0,005	-0,280	0,000	-0,010	-0,005	0,055	-0,010	0,025	0,145	0,025
m diff	-0,023	0,009	-0,253	0,079	-0,011	-0,015	0,068	-0,046	0,148	0,100	0,022
st diff	0,016	0,011	0,054	0,280	0,011	0,014	0,055	0,049	0,181	0,040	0,033
D	0,028	0,014	0,259	0,291	0,015	0,021	0,088	0,067	0,234	0,108	0,039

SLOPE	0,969	0,975	0,914	2,164	0,974	0,968	0,967	1,063	0,892	0,934	1,060
BIAS	0,124	0,073	0,512	-3,959	0,097	0,119	0,041	-0,157	0,219	0,122	-0,218
CORREL.	0,999	1,000	0,991	0,662	1,000	1,000	0,987	0,991	0,850	0,996	0,997

LIMITI DI ISO8968-1/IDF20-2:2010 r=0,038 g/100g

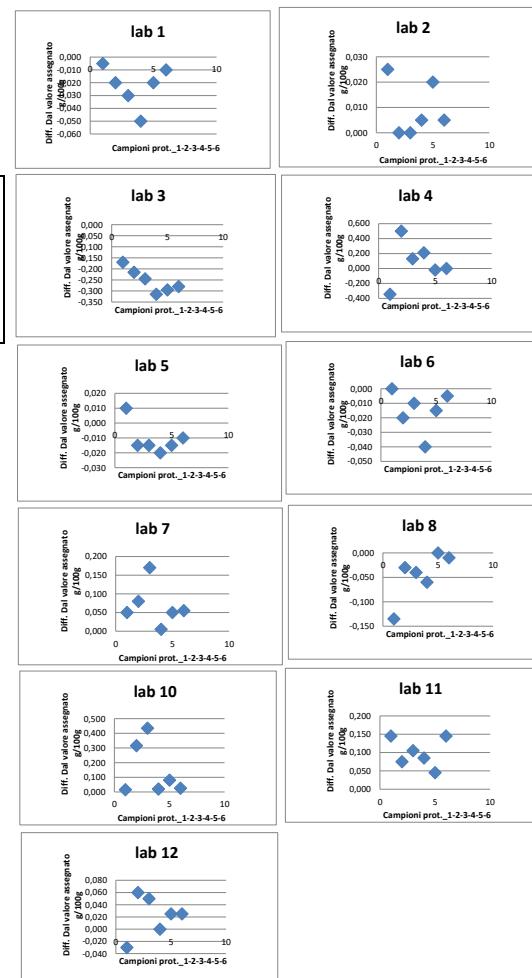




RING TEST METODI DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017


ORDINAMENTO LABORATORI

CONTENUTO IN PROTEINE g/100g

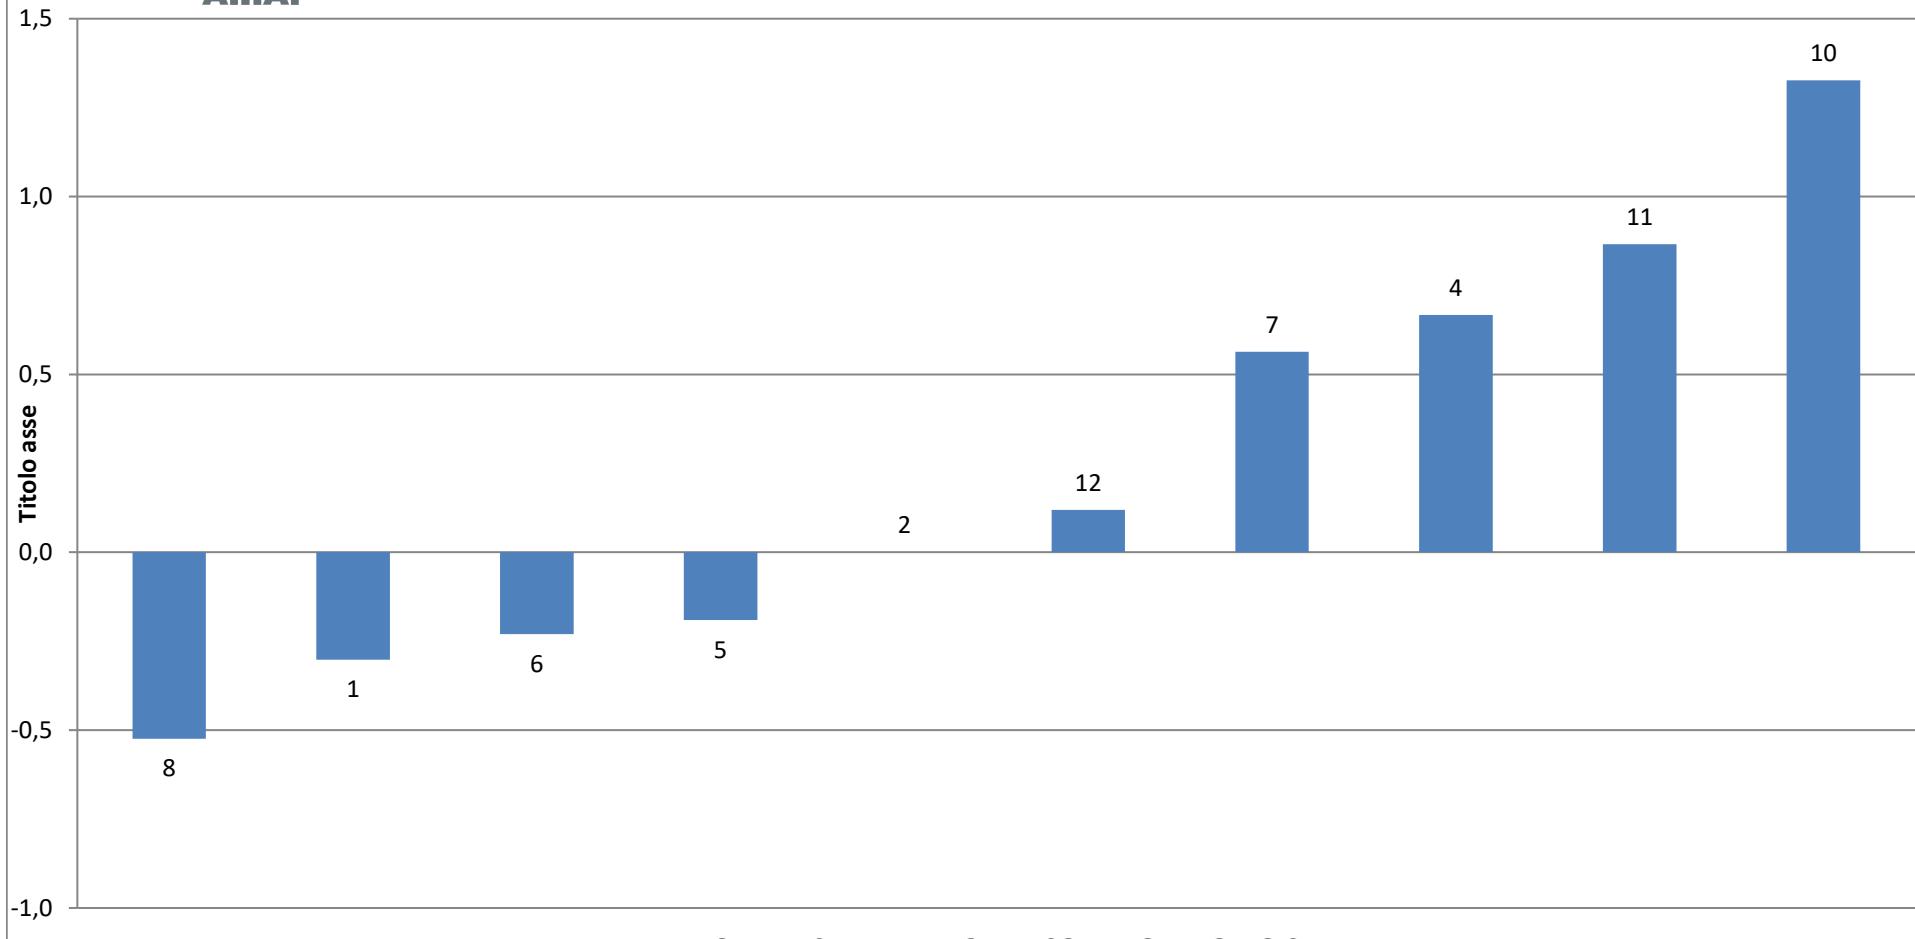



RING TEST METODI DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 CONTENUTO IN PROTEINE g/100g

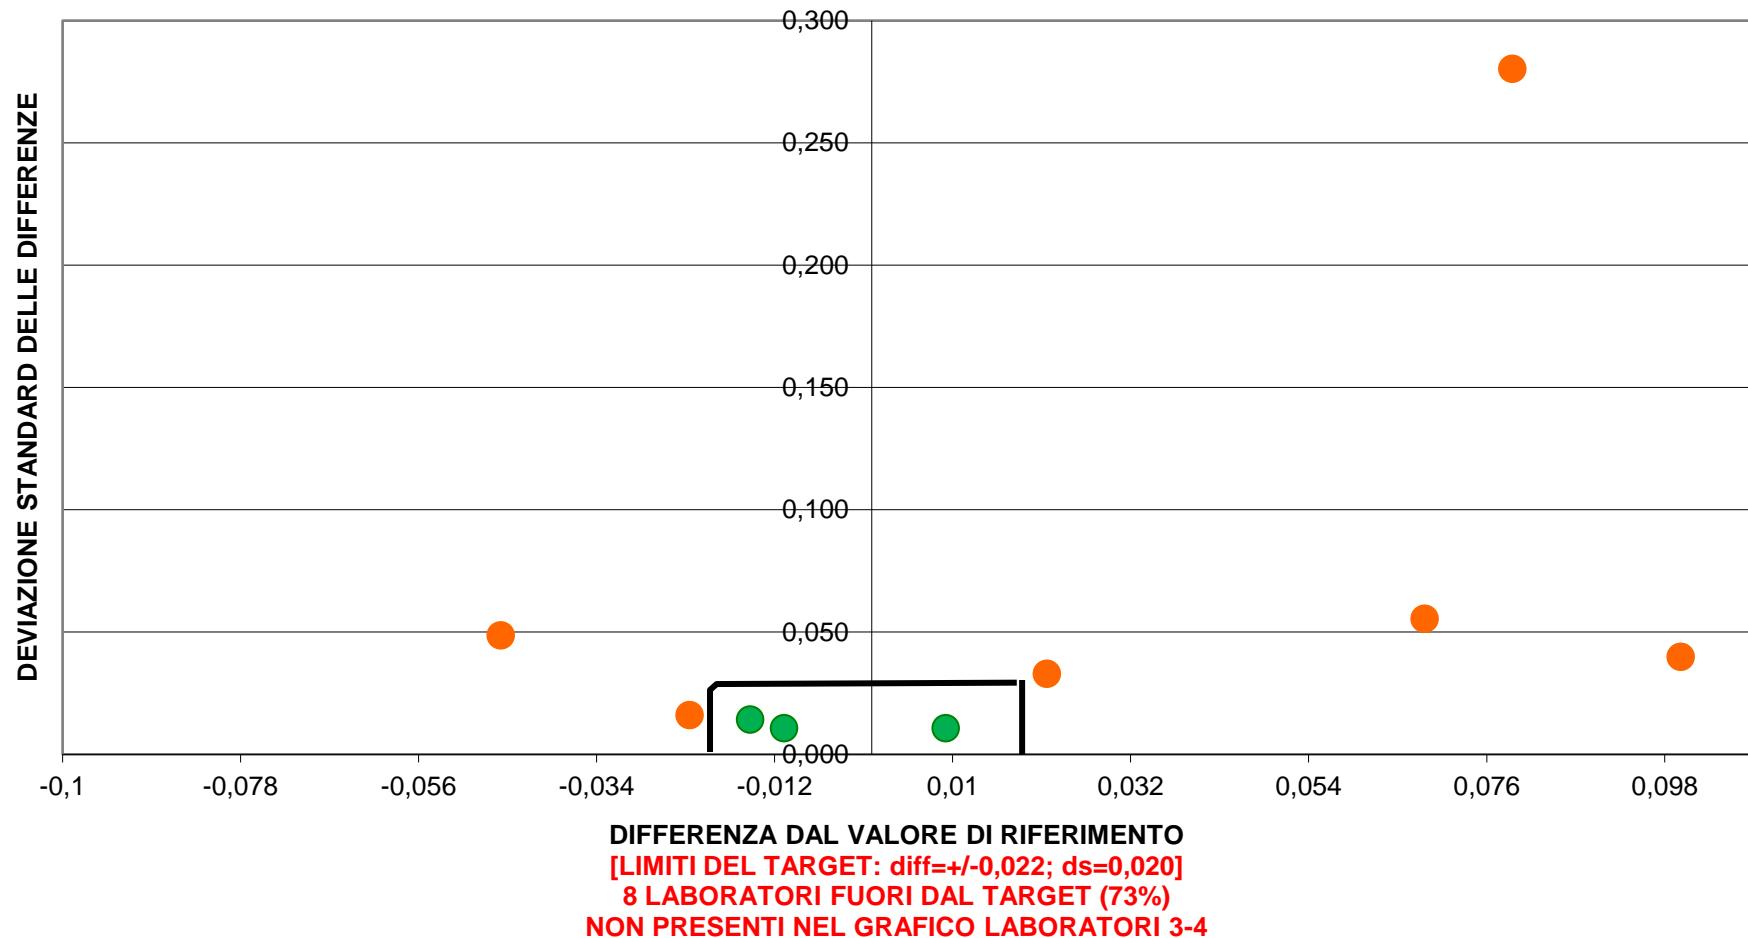



RING TEST RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017

CONTENUTO IN CASEINE g/100g

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2,98	3,00	2,84			3,03	2,86				3,00	
2	1,97	1,96	2,04			2,02	2,34				2,06	
3	2,43	2,44	2,35			2,50	2,60				2,56	
4	2,29	2,32	2,01			2,34	2,30				2,31	
5	2,61	2,62	2,38			2,62	2,50				2,63	
6	2,52	2,48	2,31			2,54	2,44				2,54	
1	3,01	2,99	2,81			3,03	2,88				2,99	
2	1,99	1,98	2,01			2,02	2,36				2,06	
3	2,46	2,46	2,32			2,50	2,61				2,54	
4	2,30	2,35	2,03			2,35	2,30				2,31	
5	2,59	2,59	2,35			2,61	2,51				2,66	
6	2,50	2,50	2,33			2,54	2,45				2,51	

MEDIA DELLE DUE RIPETIZIONI

1	2,995	2,995	2,825			3,030	2,870					
2	1,980	1,970	2,025			2,020	2,350					
3	2,445	2,450	2,335			2,500	2,605					
4	2,295	2,335	2,020			2,345	2,300					
5	2,600	2,605	2,365			2,615	2,505					
6	2,510	2,490	2,320			2,540	2,445					

m lab 2,471 2,474 2,315


ZS CAMP. 1	0,000	0,000	-2,047			0,421	-1,505					
ZS CAMP. 2	-0,299	-0,369	0,018			-0,018	2,303					
ZS CAMP. 3	-0,320	-0,266	-1,491			0,266	1,385					
ZS CAMP. 4	-0,081	0,244	-2,320			0,326	-0,041					
ZS CAMP. 5	-0,024	0,024	-2,268			0,119	-0,931					
ZS CAMP. 6	0,123	-0,123	-2,215			0,492	-0,677					

ZS LAB -0,267 -0,224 -2,308
ZS (ST FISSO) -0,681 -0,569 -5,875

DIFFERENZE DAL VALORE DI RIFERIMENTO

1	0,000	0,000	-0,170			0,035	-0,125					
2	-0,043	-0,053	0,002			-0,002	0,328					
3	-0,030	-0,025	-0,140			0,025	0,130					
4	-0,010	0,030	-0,285			0,040	-0,005					
5	-0,003	0,002	-0,238			0,013	-0,098					
6	0,010	-0,010	-0,180			0,040	-0,055					
m diff	-0,021	-0,012	-0,148			0,024	0,082					
st diff	0,019	0,035	0,118			0,019	0,194					
D	0,028	0,037	0,190			0,031	0,211					
SLOPE	0,963	0,961	1,033			0,970	1,440					
BIAS	0,110	0,107	0,072			0,050	-1,197					
CORREL.	1,000	0,997116	0,958			0,999	0,924					

LIMITI DI ISO17997-2/IDF29-2 D:1996 r=0,038 g/100g

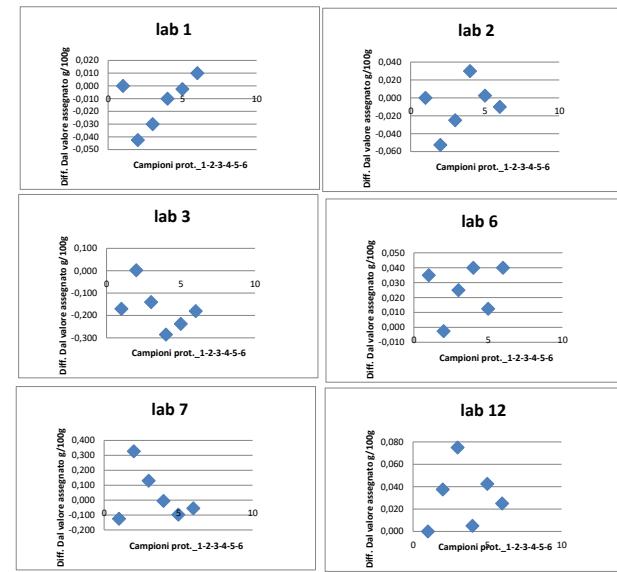



RING TEST METODI DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017
ORDINAMENTO LABORATORI
CONTENUTO IN CASEINE g/100g

